


ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΡΩΝΟΥΝ

Τώρα με αποζημίωση ΕΟΠΥΥ¹

Σύστημα FreeStyle Libre Ελευθερία στη ζωή με το διαβήτη

Τώρα διατίθεται
στα Φαρμακεία

- Ακρίβεια² και ευκολία στη χρήση**
Αντικαθιστά με ασφάλεια τη μέτρηση γλυκόζης αίματος^{3,4}
απαλλάσσοντας τα άτομα με διαβήτη από τα τρυπήματα στα δάκτυλα⁵
- Μείωση υπογλυκαιμίας^{3,4}**
Το σύστημα FreeStyle Libre συμβάλλει στη μείωση του χρόνου
σε υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας^{3,4}
- Αυτόματη καταγραφή
της γλυκόζης μέρα-νύχτα**
Βοηθά στον εύκολο εντοπισμό των τάσεων της
γλυκόζης και των νυχτερινών υπογλυκαιμιών.
- Ολοκληρωμένη εικόνα⁶**
Παρέχει ξεκάθαρη απεικόνιση των διακυμάνσεων της γλυκόζης⁷
για καλύτερη καθημερινή διαχείριση του διαβήτη

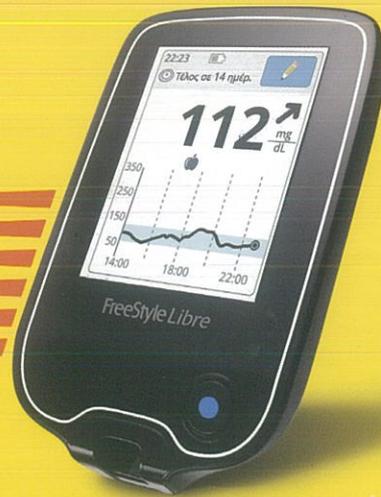


**FreeStyle
Libre**

1. Οι αισθητήρες FreeStyle Libre αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με μηδενική συμμετοχή σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, ηλικίας άνω των 4 ετών.
2. Bailey T et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. *Diabetes Technology & Therapeutics*. 2015;17(11):787-7943.
3. Bolinder, Jan., et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. *The Lancet* 388.10057 (2016): 2254-2263
4. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. *Diabetes Therapy* 8.1 (2017): 55-73
5. Η σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί τη χρήση σκαρφαλιτήρων. Ο έλεγχος με τρύπημα στο δάκτυλο χρησιμοποιώντας ένα μετρητή γλυκόζης αίματος είναι απαραίτητος σε περιόδους απότομης μεταβολής των επιπέδων γλυκόζης, όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο διάμεσο υγρό δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, όταν καταγράφεται από το σύστημα υπογλυκαιμία ή επικείμενη υπογλυκαιμία, ή όταν τα συμπτώματα δεν ταιριάζουν με τις ενδείξεις του συστήματος.
6. Με την προϋπόθεση ότι ο αισθητήρας αντικαθίσταται κάθε 14 ημέρες και αφαιρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 8 ώρες.
7. Μέσω της αναφοράς του Προφίλ Διακύμανσης Γλυκόζης (AGP) που περιλαμβάνεται στο λογισμικό του συστήματος FreeStyle Libre.

Το FreeStyle, το Libre και οι σχετικές εμπορικές επωνυμίες είναι εμπορικά σήματα της Abbott Diabetes Care, Inc. σε διάφορες δικαιούσες. Άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.


life. to the fullest.™
Abbott